

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:

**PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWY STERYLNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH
Znak sprawy: WszSL/DZ-48/18**

W odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

PYTANIA WYKONAWCY NR 1

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w pakiecie 4 poz. 9 poprzez zapis „Przyrząd do przetoczeń z precyzyjnym regulatorem przepływu” Zamawiający wymaga zaoferowania kompletnego zestawu z regulatorem przepływu ze skalą od 0 do 250 ml/godz., z dodatkowym portem, bursztynowego do leków światłoczułych o długości 210 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 7 poz. 1: Cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego miękkiego materiału zapobiegającego zwężeniu naczyń, odporny na zginanie z przyjaznymi dla pacjenta przedłużaczami, cewnik o przekroju 14 Fr i długości (15 cm, 20 cm, 24 cm)*, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny, kompletny do implantacji w skład, którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 60-70 cm, strzykawka 5 ml z tłokiem, rozszerzacz; rozmiar 12 Fr x 15 cm, rozszerzacz, rozmiar 8 Fr x 10 cm, heparynizowane nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, klips mocujący cewnik.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie, czy w pakiecie 7 pozycji 2 Zamawiający wymaga zaoferowania koreczków dezynfekcyjnych z końcówkami Luer typu żeńskiego (Female) i typu męskiego (Male) do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 10: Prowadnica Lunderquista, giętkie zakończenie na dł. 7,5 cm, długość 82cm, średnica 0.035" - sterylna, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia-papier, oznaczenie rozmiaru i data ważności na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 12 poz. 6 zamkniętego systemu składającego się z worka do diurezy godzinowej o poj. 2000 ml, komory pomiarowej o. poj. 500 ml z drenem o dł. 150 cm. Komora pomiarowa o dokładności pomiaru 1 ml w zakresie od 0 – 20 ml; co 5 ml od 20 – 110 ml; co 10 ml od 110 – 140 ml; co 20 ml od 140 – 200 ml; co 25 ml od 200 – 500 ml; nie załamująca się rurka przepływowa z zaworem antyrefluksyjnym pomiędzy komorą pomiarową i workiem, komora skraplająca, filtr hydrofobowy

w worku i komorze, 2 x bezigłowe porty do pobierania próbek moczu - bezpośrednio z komory pomiarowej i łącznika w drenie, uniwersalny wieszak samopoziomujący.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIA WYKONAWCY NR 2

Pytanie nr 6

ad pakiet 1 pozycje 1 i 2

Czy ze względu na przeznaczenie igieł do aspiracji/biopsji szpiku z mostka Zamawiający oczekuje, że oferowane igły mają być wyposażone w metalowe przyłącze luer-lock do podłączenia strzykawki aspiracyjnej ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

ad pakiet 1 pozycja 3

Wnosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert w tej pozycji na igły z miarką podziałową na zewnętrznej kaniuli tnącej co 1cm, mandrynem oznakowanym kolorystycznie, pozostałe parametry jak opisane w SIWZ.

W igłach do trepanobiopsji z kaniulą ekstrakcyjną skala podziałowa co 1cm stosowana jest na zewnętrznej kaniuli tnącej dla ułatwienia wprowadzania igły i jej obserwacji w USG.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIA WYKONAWCY NR 3

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 1 igłę do biopsji szpiku z regulacją w zakresie 10-30-50 mm przy zachowaniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIA WYKONAWCY NR 4

Pytanie nr 9

Pakiet nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści Bezpieczne igły aspiracyjne na mostku w rozmiarze: 15G o długości 6,8cm które można wykonać, regulując ogranicznik igły, aby kontrolować głębokość penetracji. Ogranicznik igły może zostać usunięty przy zasysaniu przy grzebieniu biodrowym. Złącze Luer Lock na rękojeści do bezpiecznego zamocowania strzykawki. Regulowany, zdejmowany ogranicznik igły bezpiecznie kontroluje głębokość penetracji.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10

Pakiet nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania igły do pobierania szpiku kostnego w rozmiarze 13G o długości 5,1cm z przeznaczeniem do allogenicznych i autologicznych procedur przeszczepiania szpiku kostnego. Dostępne są ze standardową końcówką stożkową lub końcówką z podwójnym diamentem i bocznymi otworami, aby umożliwić efektywne zasysanie. Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt typu twist-lock zapewnia większa komfort pobrania próbki. Igły do pobierania szpiku kostnego posiadają łącznik Luer Lock na rączce, który umożliwia bezpieczne zamocowanie strzykawki.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

Pakiet nr 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych jednoświatłowy 5FR o dł. 15 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca, łącznik typu 'Y', strzykawka o pojemności 5ml, skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12

Pakiet nr 17, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych jednoświatłowy 5FR o dł. 20 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca, łącznik typu 'Y', strzykawka o pojemności 5ml, skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13

Pakiet nr 17, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych jednoświatłowy 5FR o dł. 15 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca, łącznik typu 'Y', kabelek EKG, strzykawka o pojemności 5ml, skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Pakiet nr 17, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych dwuświatłowy 6FR o dł. 20 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca, łącznik typu 'Y', strzykawka o pojemności 5ml, skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15

Pakiet nr 17, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych dwuświatłowy 6FR o dł. 20 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca, łącznik typu 'Y', strzykawka o pojemności 5ml, skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16

Pakiet nr 17, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych trójświatłowy 6FR o dł. 20 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca, łącznik typu 'Y', strzykawka o pojemności 5ml, skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17

Pakiet nr 17, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych trójświatłowy 6FR o dł. 20 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca, łącznik typu 'Y', strzykawka o pojemności 5ml, skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18

Pakiet nr 17, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych czteroświatłowy 7FR o dł. 20 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca, łącznik typu 'Y', strzykawka o pojemności 5ml, skalpel, prowadnica ze stali nierdzewnej typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIA WYKONAWCY NR 5

Pytanie nr 19

Pakiet 2, poz. 1-4, 9-12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie w tych pozycjach, jako jednostkę miary opakowanie i wyrazi zgodę na przeliczenie ilości na opakowania. W pozycjach: 1-3, 9-12 cena i ilość strzykawek pakowanych po 100 sztuk, w poz. 4 cena i ilość za opakowanie 80 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy. Natomiast w celu ułatwienia wyceny jednej sztuki wyrobu, dopuszcza przedstawienie ceny jednostkowej z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Jednocześnie przypominamy, że w Rozdziale XIII SIWZ w części: „UWAGA” Zamawiający określił w jaki sposób Wykonawcy powinni wyliczyć oferowane ilości wyrobu, tak aby oferta była zgodna z wymaganiami.

Pytanie nr 20

Pakiet 3, poz. 11

Proszę o doprecyzowanie, czy podana ilość opakowań, to ilość opakowań po 100 sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza. Zamawiający wprowadził odnośną zmianę.

Pytanie nr 21

Pakiet 3, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści igły typu motylek 0,6; 0,7; 0,8 o dł. 20 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22

Pakiet 4, poz. 5, 6, 7

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrząd posiadał zaczep na dren, w celu możliwości ustabilizowania drenu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23

Pakiet 4, poz. 5, 6, 7


Czy Zamawiający wymaga, aby przyrząd posiadał zabezpieczenie na igłę biorczą po użyciu, w celu możliwości zabezpieczenia kolca po zakończeniu infuzji lub podczas przerwania infuzji?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24

Pakiet 4, poz. 9

Czy Zamawiający ma na myśli przyrząd z precyzyjnym regulatorem przepływu w ml/h, jak na rysunku poniżej, tzn. ze skalą i regulatorem kołowym, który można obsługiwać jedną ręką.

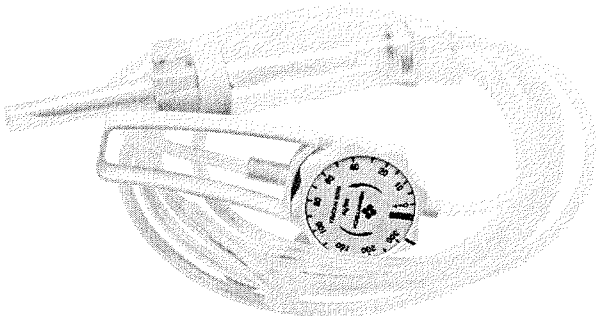

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25

Pakiet 20, poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza kaniulę wykonaną z teflonu FEP? Zarówno bowiem PTFE i FEP to teflon. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26

Pakiet 20, poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza kaniulę wykonaną z poliuretanu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27

Pakiet 20, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje kaniuli, która widoczna jest nie tylko w USG, ale także i RTG, czyli posiada paski radiocieniujące?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28

Pakiet 20, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę:

do żył obwodowych dla niemowląt, dzieci. Kaniula ze skrzydełkami, z portem iniekcyjnym do podawania bolusów z samodomykającym się koreczkiem nie wymagającym dociskania w celu zamknięcia, wykonana z termoplastycznego PTFE, bez lateksu, bez PVC, widoczna w USG oraz RTG, o wysokim współczynniku penetracji /ostrości/, z filtrem hydrofobowym pełniącym tę samą funkcję co zastawka antyzwrotna zapobiegającym wypływowi krwi podczas wkłucia, widoczna data ważności na opakowaniu jednostkowym - sterylna, opakowanie typu blister z papierem klasy tyvek.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29

Pakiet 20, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę:

do żył obwodowych dla niemowląt, dzieci. Kaniula ze skrzydełkami, z portem iniekcyjnym do podawania bolusów ze standardowym koreczkiem dociskany w celu zamknięcia, wykonana z termoplastycznego FEP (zarówno bowiem FEP jak i PTFE to teflon), bez lateksu, bez PVC, widoczna w USG oraz RTG, o wysokim współczynniku penetracji /ostrości/, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi podczas wkłucia, widoczna data ważności na opakowaniu jednostkowym - sterylna, opakowanie typu blister z papierem klasy medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30

Pakiet 20, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o następujących rozmiarach:

18 G	1,20 x 38	105
20 G	1,00 x 32	64
22 G	0,80 x 25	38

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31

Pakiet 20, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę:

ze skrzydełkami, z portem iniekcyjnym do podawania bolusów z samodomykalnym koreczkiem typu klik /nie wymagającym docisnięcia do pełnego zamknięcia/, wykonana z biozgodnego PU, bez lateksu, bez PVC, kontrastująca w promieniach Rtg /4 wtopione paski kontrastujące/, o wysokim współczynniku penetracji /ostrości/, z filtrem hydrofobowym pełniącym tę samą funkcję co zastawka antyzwrotna, zapobiegającym wypływowi

krwi podczas wkłucia, widoczna data ważności na opakowaniu jednostkowym - sterylna, sterylizowana EO, opakowanie typu blister z papierem klasy tyvek .

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32

Pakiet 20, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o następujących rozmiarach:

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,2 x 45	343
Szary	16 G	1,7 x 45	196
Biały	17 G	1,5 x 45	128
Zielony	18 G	1,3 x 45 1,3 x 33	90 103
Różowy	20 G	1,1 x 33 1,1 x 25	61 65
Niebieski	22 G	0,9 x 25	36

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33

Pakiet 20, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę:

ze skrzydełkami, z portem iniekcyjnym do podawania bolusów ze standardowym koreczkiem dociskany w celu zamknięcia / , wykonana z biozgodnego PU, bez lateksu , bez PVC, kontrastująca w promieniach Rtg / 4 wtopione paski kontrastujące/, o wysokim współczynniku penetracji /ostrości/, z zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi podczas wkłucia, widoczna data ważności na opakowaniu jednostkowym - sterylna, sterylizowana EO, opakowanie typu blister z papierem klasy medycznej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34

Pakiet 20, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o następujących rozmiarach:

14 G	2,20 x 45	290
16 G	1,70 x 45	180
17 G	1,50 x 45	140
18 G	1,20 x 45	100
20 G	1,00 x 32	64
22 G	0,80 x 25	38

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIA WYKONAWCY NR 6

Pytanie nr 35

Pakiet nr 5, pozycja nr 11

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby zatyczki były sterylne ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga sterylnych zatyczek..

Pytanie nr 36

Pakiet nr 6, pozycja nr 20

Ponieważ igły typu Echoplex posiadają szlif 20', prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł ze szlifem 20'

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 37

Pakiet nr 7, pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków dezynfekcyjnych wykazujących skuteczność po 1 minucie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 38

Pakiet nr 7, pozycja nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby data ważności oraz nr serii były umieszczone bezpośrednio na każdym pojedynczym koreczku?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 39

Pakiet nr 9, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych łyżek laryngoskopowych McIntosh w rozmiarach o oznaczeniu 1, 2, 3. Producenci stosują różne oznaczenia numeracji, jest to tylko różnica w numeracji.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował SIWZ w zakresie Pakietu nr 9, poz. 1 i wymaga zgodnie z dokonanymi zmianami.

Pytanie nr 40

Pakiet nr 9, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wymaga aby łyżki laryngoskopowe posiadały ochronny pokrowiec umożliwiający sterylne założenie łyżki ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 41

Pakiet nr 9, pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych łyżek laryngoskopowych typu Miller w rozmiarach o oznaczeniu 00, 0, 1, 2.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował SIWZ w zakresie Pakietu nr 9, poz. 2 i wymaga zgodnie z dokonanymi zmianami.

Pytanie nr 42

Pakiet nr 9, pozycja nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby łyżki laryngoskopowe posiadały ochronny pokrowiec umożliwiający sterylne założenie łyżki ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 43

Pakiet nr 17, pozycja nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika o średnicy kanałów 14G/14G. Pozostałe wymagania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 44

Pakiet nr 18, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wymaga ze względu na specyficzne wymagania pracy przy wcześniejszych dodatkowego znacznika głębokości znajdującego się w połowie znakowania sondy ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 45

Pakiet nr 18, pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu nie zawierającego filtra.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIA WYKONAWCY NR 7

Pytanie nr 46

Pakiet 16

Czy zamawiający wydzieli z pakietu 16 pozycje nr 5?

Odpowiedź: Pakiet 16 jest podzielony na pozycje od początku wszczęcia postępowania i możliwe jest składanie ofert w zakresie poszczególnych pozycji.

Pytanie nr 47

Pakiet 16

Czy zamawiający w pozycji nr 4 dopuści rurkę intubacyjną z mankietem niskociśnieniowym z nietransparentnym łącznikiem 15mm pozostałe zapisy bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48

Pakiet 16 pozycja 1 i 2. Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną silikonowaną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów.

Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 49

Pakiet 16 pozycja 1 i 2. Czy Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej z oznaczeniem średnicy rurki i mankieta na baloniku kontrolnym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 50

Czy Zamawiający wymaga rurki intubacyjnej ze znacznikiem głębokości w postaci grubego ringu dookoła rurki?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 51

Pakiet 16 pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści rurkę silikonowaną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów.

Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

PYTANIA WYKONAWCY NR 8

Pytanie nr 52

Pakiet nr 13, Pozycja nr 1,2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie 6-miesięcznych zestawów do szynowania moczowodów o rozmiarach CH 4.7/280mm, CH6/260,280mm, CH7 260,280mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 53

Pakiet nr 13, Pozycja nr 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie 12-miesięcznych zestawów do szynowania moczowodów wykonanych z termoczułego poliuretanu (stent jest sztywny w czasie wprowadzania, jednak po wprowadzeniu staje się miękki i elastyczny), obustronnie otwartych z przewodnicą hydrofilną w zestawie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIA WYKONAWCY NR 9

Pytanie nr 54 Pakiet 9: Poz.1.

Czy zaszła omyłka i łyżki typu MacIntosh powinny być w rozmiarach 2,3,4,5?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 55

Pakiet 9: Poz. 2.

Czy zaszła omyłka i łyżki typu Miller powinny być w rozmiarach 00,0,1?

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował SIWZ w zakresie Pakietu nr 9, poz. 2 i wymaga zgodnie z dokonanymi zmianami.

Pytanie nr 56

Pakiet 9: Poz. 1.

Czy Zamawiający prawidłowo określił liczbę sztuk? Według posiadanej przez nas wiedzy bardziej prawdopodobna jest liczba 9000 zamiast 18000.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 57

Dotyczy pakietu 21, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści układy oddechowe, składające się z dwóch rur o dł. 1,5 m i trzeciej o dł. 0,8m, spełniających wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIA WYKONAWCY NR 10

Pytanie nr 58

Pytanie dot. pakietu nr 10, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z kaniulą rozdzielną dł. 12 cm, zamiast zestawu z kaniulą rozdzielną dł. 8 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 59

Pytanie dot. pakietu nr 10, poz.1, 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego bez płytki mocującej i worka na mocz 1,5l sterylnego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 60

Pytanie dot. pakietu nr 10, poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do śródoperacyjnego i pooperacyjnego drenażu pęcherza moczowego z poliuretanowym cewnikiem CH 14 zamiast cewnika CH15. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 61

Pytanie dot. pakietu nr 10, poz.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do przezskórnej nefrostomii w składzie:

- cewnik typu J w rozmiarze 9F (dł. 24 lub 34 cm), 11 F (dł. 28cm), wykonany z poliuretanu, z łącznikiem Luer-Lock oraz jednorazowym kranikiem regulującym przepływ moczu dla cewnika CH9 oraz lejkiem do podłączenia worka na mocz dla cewnika w rozmiarze CH11;
 - igła punkcyjna dwuczęściowa, ze stali medycznej, widoczna w USG;
 - przewodnik Lunderquista 0,035", o dł. 80cm, z giętką 1,5 mm końcówką typu J;
 - rozszerzadła (w zestawie o rozmiarze 9F jedno rozszerzadło bez rozrywalnej koszulki, w zestawie o rozmiarze 11F dwa rozszerzadła, w tym ostatnie z rozrywalną koszulką);
 - uniwersalny łącznik do worka na mocz Luer-Lock w zestawie CH9, zatyczka w przypadku rozmiaru CH11;
- Zestaw jest jałowy, jednorazowy, sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 62

Pytanie dot. pakietu nr 10, poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodnicy Lunderquista, giętkie zakończenie na dł. 2-3 cm, zamiast giętkiego zakończenia na dł. 6 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 63

Pytanie dot. pakietu nr 13, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego Double J w rozmiarze Ch 4,7/ 280mm zamiast rozmiaru Ch 4,8/ 280mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 64

Pytanie dot. pakietu nr 13, poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego Double J w rozmiarze Ch 4,7/ 280mm zamiast rozmiaru Ch 4,8/ 280mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 65

Pytanie dot. pakietu nr 13, poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego Double J wykonanego z poliuretanu pokrytego fosforylocholimą – substancją która przedłuża drenaż cewnika do 12 miesięcy oraz zmniejsza infekcję i inkrustację, zamiast cewnika moczowodowego Double J wykonanego z 100% silikonu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIA WYKONAWCY NR 11**Pytanie nr 66**

Dotyczy pakietu 20 pozycja 3,

Wykonawca zwraca się o dopuszczenie kaniul dożylnych o poniższych parametrach:

Kaniuła ze skrzydełkami, z portem iniekcyjnym do podawania bolusów z samodomykalnym koreczkiem typu klik /nie wymagającym docisnięcia do pełnego zamknięcia/, wykonana z biogodnego PU, bez lateksu, bez PVC, kontrastująca w promieniach Rtg 6 wtopionych pasków kontrastujących/, o wysokim współczynniku penetracji /ostrości/, z elementem zapobiegającym wypływowi krwi podczas wkłucia, widoczna data ważności na opakowaniu jednostkowym - sterylna, opakowanie typu blister z papierem klasy Tyvek. O przepływach: G 14 x 45 o przepływach: 275-351 ml/min., G 16 x 45 o przepływach: 180-230 ml/min., G 17 x 45 o przepływach: 128-163 ml/min., G 18 x 45 o przepływach: 86-109 ml/min., G 18 x 32 o przepływach: 86-109 ml/min., G 20 x 32 o przepływach: 59-75 ml/min., G 20 x 25 o przepływach: 59-75 ml/min., G 22 x 25 o przepływach: 29-45 ml/min.

Opisane przez zamawiającego kaniule dożylne w SIWZ oferowane na rynku polskim są tylko przez firmę Becton Dickinson o nazwie handlowej Venflon Pro dotyczy to zarówno wymaganych przepływów oraz metody sterylizacji w związku z czym kaniule te nie mają swojego odpowiednika oraz tym samym nie jest możliwe złożenie oferty równoważnej spełniającej wymagania zawarte w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 67

Dotyczy pakietu 20 pozycja 3,

Czy Zamawiający wymaga kaniul dożylnych Venflon Pro firmy Becton Dickinson, które jako jedyne spełniają zawarte w SIWZ parametry?.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 68

Dotyczy pakietu 20,

Prosimy o wyjaśnienie zapisu w wymogu sterylizacji innej dla pozycji 3 a innej dla pozycji 1 i 2 (gdzie zamawiający dopuszcza sterylizacje ETO), skoro pozycja jeden to kaniule dożylne dedykowane dla noworodków?

Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie 20 w poz.3 NIE dopuszcza sterylizacji EO, tylko oczekuje innej metody sterylizacji. W pozycjach 1 i 2 Zamawiający również nie wymaga żadnej konkretnej metody sterylizacji.

Pytanie nr 69

Dotyczy pakietu 20,

Prosimy o wyjaśnienie czy w tym pakiecie Zamawiający dopuszcza składnie ofert na poszczególne pozycje skoro rozpiął wadium dla każdej pozycji?.

Odpowiedź: Pakiet 20 jest podzielony na pozycje od początku wszczęcia postępowania i możliwe jest składanie ofert w zakresie poszczególnych pozycji.

PYTANIA WYKONAWCY NR 12

Pytanie nr 70

Pakiet 9 Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie łyżek MacIntosh z tworzywa o wymiarach 1-4

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował SIWZ w zakresie Pakietu nr 9, poz. 1 i wymaga zgodnie z dokonanymi zmianami.

Pytanie nr 71

Pakiet 9 Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie łyżek Miller z tworzywa o wymiarach 0-4

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował SIWZ w zakresie Pakietu nr 9, poz. 2 i wymaga zgodnie z dokonanymi zmianami.

Pytanie nr 72

Pakiet 9 Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie rozmiarów 0-4 oraz o odstąpienie od wymogu nadruku nr serii na łyżce w przypadku gdy informacja ta znajduje się na opakowaniu jednostkowym.

Prosimy o dopuszczenie opakowania folia-papier.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 73

Pakiet 9 Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie rozmiarów 1-4 oraz o odstąpienie od wymogu nadruku nr serii na łyżce w przypadku gdy informacja ta znajduje się na opakowaniu jednostkowym.

Prosimy o dopuszczenie opakowania folia-papier.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIA WYKONAWCY NR 13

Pytanie nr 74

Czy Zamawiający w zadaniu 5, poz 10 dopuści cewnik długoterminowy renomowanego producenta, spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego o średnicach 4,8Ch-7Ch?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów.

Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 75

Czy Zamawiający w zadaniu 10, poz 4 dopuści zestaw do nefrostomii renomowanego producenta, o średnicy 8F i 10F, z 2-częściową kaniulą ze znacznikiem USG, z cewnikiem o długości ok. 30cm, prowadnicą 0,38"x80cm, 2-częściowy rozszerzacz z koszulką rozrywalną o długości ok 175mm, widocznym w rtg, końcówka L-L, adapter do worka, kranik L-L?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIA WYKONAWCY NR 14

Pytanie nr 76

Pakiet nr 19, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu dla dorosłych z drenem długości 210 cm, maska wykonana z winylu bez DEPH, z blaszką nosową dopasowującą się do twarzy pacjenta? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 77

Pakiet nr 19, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową dla osoby dorosłej Venturiego, maska wykonana z winylu, z blaszką nosową dopasowującą się do twarzy pacjenta? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 78

Pakiet nr 19, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu dla dzieci z drenem długości 210 cm, maska wykonana z winylu bez DEHP, z blaszką nosową dopasowującą się do twarzy pacjenta? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 79

Pakiet nr 19, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną, wykonana z materiału z PCV bez DEHP, nadmuchiwany miękki mankiet kodowany kolorowym pierścieniem? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIA WYKONAWCY NR 15**Pytanie nr 80**

Pakiet nr 22 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawicy lateksowej bezpudrowej koloru brązowego (antyrefleksyjna) do zabiegów ortopedycznych o powierzchni zewnętrznej delikatnie teksturowanej, wewnętrzna warstwa CPC - o działaniu bakteriobójczym i przeciwgrzybicznym, silikonowane. Wzmocnione o dużej elastyczności, szczególnej wytrzymałości i zwiększonej grubości wynoszącej w obszarze palca min. 0,32 mm, na dłoni i mankiecie $\geq 0,21$ mm. Długość min. 295 mm. Zawartość protein $< 30 \mu\text{g/g}$ rękawicy. Siła zrywania przed/po starzeniu min. 33N/26N. Badania na przenikalność min. 10 substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 lub równoważną oraz na przenikalność min. 12 cytostatyków, przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671. Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Obniżony poziom AQL wynoszącym po zapakowaniu 0,65. Opakowanie podwójne, zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIA WYKONAWCY NR 16**Pytanie nr 81**

Pakiet 2, poz. 5,7-8

Prosimy o wydzielenie poz.5,7-8 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Pakiet 2 jest podzielony na pozycje od wszczęcia postępowania i możliwe jest składanie ofert w zakresie poszczególnych pozycji.

Pytanie nr 82

Pakiet 2, poz. 7-8

Czy zamawiający dopuści odpowiednio do pozycji strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock oraz strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock bursztynową, już, sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 2 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 83

Pakiet 4, poz. 6-7

Czy Zamawiający z uwagi na charakter pakietu 4 – jego dużą wartość, wydzieli pozycje: 6-7 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorą-

cym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź: Pakiet 4 jest podzielony na pozycje od wszczęcia postępowania i możliwe jest składanie ofert w zakresie poszczególnych pozycji.

Pytanie nr 84

Pakiet 12, poz. 4-5,7

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 4-5,7 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Pakiet 12 jest podzielony na pozycje od wszczęcia postępowania i możliwe jest składanie ofert w zakresie poszczególnych pozycji.

Pytanie nr 85

Pakiet 12, poz. 4-5

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy, natomiast w celu ułatwienia wyceny jednej sztuki wyrobu, dopuszcza przedstawienia ceny jednostkowej z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Jednocześnie przypominamy, że w Rozdziale XIII SIWZ w części: „UWAGA” Zamawiający określił w jaki sposób Wykonawcy powinni wyliczyć oferowane ilości wyrobu, tak aby oferta była zgodna z wymaganiami.

Pytanie nr 86

Pakiet 12, poz. 4-5

Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml, z oświadczeniem producenta o możliwości zastosowania do 7 dni?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 87

Pakiet 12, poz. 7

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy, natomiast w celu ułatwienia wyceny jednej sztuki wyrobu, dopuszcza przedstawienia ceny jednostkowej z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Jednocześnie przypominamy, że w Rozdziale XIII SIWZ w części: „UWAGA” Zamawiający określił w jaki sposób Wykonawcy powinni wyliczyć oferowane ilości wyrobu, tak aby oferta była zgodna z wymaganiami.

Pytanie nr 88

Pakiet 19, poz. 1,2,4,6,5

Czy zamawiający dopuści produkty zawierające latex?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 89

Pakiet 19, poz. 1,2,4,6,5,7

Czy zamawiający dopuści produkty bez dokumentu poświadczającego brak zawartości ftalanów i użytego plastifikatora, oraz o braku zawartości lateksu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 90

Pakiet 19, poz. 1,2,4,6,5,7

Czy zamawiający dopuści produkty wykonane z medycznego PCV?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 91

Pakiet 19, poz. 2,4,6

Czy zamawiający dopuści produkty w skład których wchodzi dren o długości ok. 200 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 92

Pakiet 19, poz. 1,2,4,6,5

Czy zamawiający dopuści produkty wykonane z medycznego PCV?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 93

Pakiet 19, poz. 1,2,4,6,5

Czy zamawiający dopuści dren o przekroju prostym, wzmocniony, niezałamujący się?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 94

Pakiet 19, poz.3

Prosimy o wydzielenie poz.3 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź:

Pakiet 19 jest podzielony na pozycje od wszczęcia postępowania i możliwe jest składanie ofert w zakresie poszczególnych pozycji.

Pytanie nr 95

Pakiet 19, poz. 7

Czy zamawiający dopuści maskę z pompowanym mankietem, jednorazową, wykonaną z nietoksycznego materiału PVC +PC, kodowane kolorystycznie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIA WYKONAWCY NR 17**Pytanie nr 96**

dotyczy pakietu nr 2, poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek z rozszerzoną skalą pomiarową?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 97

dotyczy pakietu nr 2, poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek z podwójną skalą pomiarową?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 98

dotyczy pakietu nr 2, poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek pozbawionych ftalanów, z informacją o ich braku na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 99

dotyczy pakietu nr 2, poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek posiadających kolorowy kontrastujący tłok (nie mleczny)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 100

dotyczy pakietu nr 2, poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek z logo producenta na cylindrze?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 101

dotyczy pakietu nr 2, poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek dwuczęściowych z tłokiem prostym na całej długości cylindra, z ewentualnym przewężeniem zapewniającym pewny uchwyt wyłącznie na końcu tłoka? Zadajemy to pytanie ponieważ na rynku pojawiły się strzykawki gdzie przewężenie tłoka sięga nawet połowy jego długości co negatywnie wpływa na stabilność strzykawki podczas pracy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 102

dotyczy pakietu nr 2, poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek posiadających podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 103

dotyczy pakietu nr 2, poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek w opakowaniach jednostkowych (pojedyncza sztuka) wyraźnie zróżnicowanych kolorystycznie w zależności od rozmiaru ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 104

dotyczy pakietu nr 2, poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za op=100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy, natomiast w celu ułatwienia wyceny jednej sztuki wyrobu, dopuszcza przedstawienia ceny jednostkowej z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Jednocześnie przypominamy, że w Rozdziale XIII SIWZ w części: „UWAGA” Zamawiający określił w jaki sposób Wykonawcy powinni wyliczyć oferowane ilości wyrobu, tak aby oferta była zgodna z wymaganiami.

Pytanie nr 105

dotyczy pakietu nr 2, poz. 5,7,8

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek z dwustronną skalą pomiarową?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 106

dotyczy pakietu nr 4, poz. 5,6

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z dużą i wygodną w użytkowaniu komorą kroplową o długości minimum 65mm w części przezroczystej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 107

dotyczy pakietu nr 4, poz. 5,6,7

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów posiadających gumkę lub opaskę stabilizującą dren wewnątrz opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 108

dotyczy pakietu nr 4, poz. 5,6,7

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania przyrządów z nazwą producenta bezpośrednio na przyrządzie w celu identyfikacji bez opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 109

dotyczy pakietu nr 4, poz. 5,6,7

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z komorą kroplową wolną od PVC? Komora wolna od PVC jest bardziej przejrzysta i elastyczna co znacznie poprawia komfort pracy personelu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 110

dotyczy pakietu nr 4, poz. 5,6,7

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów w opakowaniu folia papier?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 111

dotyczy pakietu nr 4, poz. 5,6,7

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z zaciskaczem wyposażonych w uchwyt na dren?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 112

dotyczy pakietu nr 4, poz. 5,6,7

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia producenta lub karty katalogowej z informacją z jakiego materiału wykonana jest komora kroplowa? Producenci przyrządów pochodzących z Chin często twierdzą że ich przyrządy posiadają komorę kroplową wolną od PVC ale jednocześnie nie są w stanie stwierdzić z jakiego materiału jest wykonana co rodzi uzasadnione wątpliwości.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 113

dotyczy pakietu nr 4, poz. 5,6,7

Czy Zamawiający wymaga aby informacja o braku ftalanów znajdowała się na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby informacja o braku ftalanów znajdowała się na opakowaniu jednostkowym.

Pytanie nr 114

dotyczy pakietu nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek wykonanych z PVC?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 115

dotyczy pakietu nr 20, poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane kaniule posiadały znaczniki RTG tak jak w poz. 3? Jeżeli nie to prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIA WYKONAWCY NR 18

Pytanie nr 116

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 7, 8 dopuści do wyceny powszechnie stosowanych strzykawek trzyczęściowych 50 ml MARGOMED?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 117

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 10 dopuści do wyceny strzykawki tuberkulinowej 3-częściowej 1 ml z dołączoną igłą?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 118

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 12 wyrazi zgodę na wycenę op. x 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy, natomiast w celu ułatwienia wyceny jednej sztuki wyrobu, dopuszcza przedstawienia ceny jednostkowej z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Jednocześnie przypominamy, że w Rozdziale XIII SIWZ w części: „UWAGA” Zamawiający określił w jaki sposób Wykonawcy powinni wyliczyć oferowane ilości wyrobu, tak aby oferta była zgodna z wymaganiami.

Pytanie nr 119

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 12 wyrazi zgodę na wycenę igły typu motylek w rozmiarze 0,5x19mm zamiast 0,5x20mm.?

Odpowiedź: W Pakiecie 2 nie występują igły

Pytanie nr 120

Czy Zamawiający w Pakiecie 20 poz. 1 dopuści do wyceny kaniule wykonane z FEP, o przepływie dla rozm. 24G 23ml/min. oraz dla rozm. 26G 17ml/min.?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 121

Czy Zamawiający w pakiecie 20 poz. 2 dopuści do wyceny kaniule w rozmiarze: 22G 0,9x25 o przepływie 36 ml/min.; 20G 1,1x32 o przepływie 56ml/min.; 18G 1,3x45 o przepływie 90ml/min.? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 122

Czy Zamawiający w Pakiecie 20 poz. 3 dopuści do wyceny kaniule z trzema paskami kontrastującymi w promieniach RTG, z filtrem hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki, sterylizowane tlenkiem etylenu, w rozmiarach:

0,9x25 przepływ 36ml/min.; 1,1x32 przepływ 56ml/min.; 1,3x45 przepływ 90ml/min.; 1,5x45 przepływ 142ml/min.; 1,7x45 przepływ 200ml/min.; 2,1x45 przepływ 305ml/min.?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIA WYKONAWCY NR 19**Pytanie nr 123**

Pakiet 14 poz.1

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne maski krtaniowe renomowanej firmy Ambu z mocno uwypukloną kopułą zapobiegającą wklonowaniu nagłośni?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 124

Pakiet 14 poz.2

Czy Zamawiający oczekuje masek krtaniowych z mankietem powietrznym w rozmiarach o1 do 6, anatomicznej 90 stopniowej krzywiźnie rurki oddechowej, z wbudowaną blokadą zgryzu, z mocno uwypukloną kopułą zapobiegającą wklonowaniu nagłośni, z dużym kanałem gastrycznym (możliwość umieszczenia sondy 16 Fr dla masek rozmiar 3, 4, 5, 6) z możliwością wykonania intubacji poprzez rurkę maski, charakteryzującą się wysokim ciśnieniem uszczelnienia udokumentowanym badaniami, osiagającym 40 cm H₂O, produkt pozbawiony wszystkich szkodliwych ftalanów (w tym DEHP, DBP, BBP, DIBP, DMEP, DIPP, DHNUP, DPP)-informacja zamieszczona na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 125

Pakiet 14 poz.5

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie jako równoważnych masek krtaniowych renomowanej firmy Ambu z mankietem powietrznym w rozmiarach 01 do 6, anatomicznej 90 stopniowej krzywiźnie rurki oddechowej, z wbudowaną blokadą zgryzu, z mocno uwypukloną kopułą zapobiegającą wklonowaniu na głośni, z dużym kanałem gastrycznym (możliwość umieszczenia sondy 16 Fr dla masek rozmiar 3, 4, 5, 6) z możliwością wykonania intubacji poprzez rurkę maski, charakteryzującą się wysokim ciśnieniem uszczelnienia udokumentowanym badaniami, osiagającym 40 cm H₂O, produkt pozbawiony wszystkich szkodliwych ftalanów (w tym DEHP, DBP, BBP, DIBP, DMEP, DIPP, DHNUP, DPP)-informacja zamieszczona na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 126

Pakiet 14

Czy zamawiający oczekuje, aby maski krtaniowe były pozbawione wszystkich szkodliwych ftalanów (w tym DEHP, DBP, BBP, DIBP, DMEP, DIPP, DHNUP, DPP), które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania min. na alergię, astmę, nowotwory, oraz wykazują negatywny wpływ na organizm dzieci?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 127

Pakiet 19 poz.2

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę do podawania tlenu dla dorosłych z drenem długości 200 cm, jednorazowego użytku, opakowanie pojedyncze, gwiazdkowy przekrój przewodu utrudniający przypadkowe zagięcie i odcięcie tlenu, maska wykonana z delikatnego, medycznego PVC bez DEHP, ze szczelnie przylegającym mankietem zapewniającym komfort, wyprofilowanym zachyłkiem nosowym z blaszką, mocowana przy pomocy gumki?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 128

Pakiet 19 poz.3

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę tlenową dla osoby dorosłej Venturiego, wykonaną z delikatnego, medycznego PVC, z drenem o dł.200 cm, ze szczelnie przylegającym mankietem zapewniającym komfort, wyprofilowanym zachyłkiem nosowym z blaszką, mocowaną przy pomocy gumki, nie zawierająca lateksu, dodatkowo produkt pozbawiony jest szkodliwych ftalanów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 129

Pakiet 19 poz.4

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę do podawania tlenu dla dzieci z drenem długości 200 cm, jednorazowego użytku, opakowanie pojedyncze, gwiazdkowy przekrój przewodu utrudniający przypadkowe zagięcie i odcięcie tlenu, maska wykonana z delikatnego, medycznego PVC bez DEHP, ze szczelnie przylegającym mankietem zapewniającym komfort, wyprofilowanym zachyłkiem nosowym z blaszką, mocowana przy pomocy gumki?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 130

Pakiet 19 poz.1,3,5,6

Czy zamawiający wymaga żeby w/w pozycje były pozbawione szkodliwych ftalanów, które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizm dzieci?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 131

Pakiet 21 poz.1

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę aerozolowa dla dorosłych z nebulizatorem typu Cirrus i drenem, maska wykonana z delikatnego, medycznego PVC bez DEHP, ze szczelnie przylegającym mankietem zapewniającym komfort, wyprofilowanym zachyłkiem nosowym z blaszką, maska z otworami bocznymi, mocowana przy pomocy gumki, nebulizator 8 ml, skalowanie co 2 ml, dren o przekroju gwiazdkowym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 132

Pakiet 21 poz.2

Maska aerozolowa dla dzieci i noworodków z nebulizatorem typu Cirrus i drenem, maska wykonana z delikatnego, medycznego PVC bez DEHP, ze szczelnie przylegającym mankietem zapewniającym komfort, wyprofilowanym zachyłkiem nosowym z blaszką, maska z otworami bocznymi, mocowana przy pomocy gumki, nebulizator 8 ml, skalowanie co 2 ml, dren o przekroju gwiazdkowym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 133

Pakiet 21 poz.3

Czy zamawiający dopuści jako równoważny nebulizator typu Cirrus z rurką T do układu oddechowego dla dorosłych z drenem 200 cm, pojemność zbiorniczka na lek 8ml, dokładnie skalowany co 2ml, spełniający pozostałe wymogi SIWZ, dodatkowo produkt pozbawiony jest szkodliwych ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 134

Pakiet 21 poz.5

Czy zamawiający dopuści jako równoważny jednorazowy układ oddechowy do aparatu do znieczulania, dla dorosłych, składający się z rur o gładkich powierzchniach wewnętrznych, z czego dwie o długości 1,8 m z miękkimi zakończeniami 22F od strony urządzenia i jedna gałąź do worka o długości 90 cm, worek oddechowy bezłateksowy o pojemności 2l, Y pacjenta z możliwością odłączenia gałęzi, łącznik prosty 22M/22M, kapturek zabezpieczający układ oddechowy, pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIA WYKONAWCY NR 20

Pytanie nr 135

Pytanie dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do wzoru Umowy zapisu następującej treści:

"Strony zgodnymi oświadczeniami woli ustalają, iż, zgodnie z zasadą dobrowolności stosowania mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment), we wzajemnych rozliczeniach Stron nie będzie stosowany wskazany wyżej mechanizm"?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 136

Pytanie ogólne

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej netto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej strzykawki, rękawiczki, itp.).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedstawienia ceny jednostkowej z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Pytanie nr 137

Pakiet nr 2, pozycje 6 - 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Pakiet 2 jest podzielony na pozycje i możliwe jest składanie ofert w zakresie poszczególnych pozycji.

Pytanie nr 138

Pakiet nr 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę insulinową z wtopioną igłą w rozmiarze 0,33 x 12,5mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 139

Pakiet nr 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę insulinową z dołączoną (nie wtopioną) igłą w rozmiarze 0,4 x 13mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 140

Pakiet nr 2, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową z dołączoną (nie wtopioną) igłą?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 141

Pakiet nr 3, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści igłę do pobierania leków w rozmiarze 1,2 x 30mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 142

Pakiet nr 3, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści igły typu „motylek”, o długości 19mm z drenem o długości 30cm zakończonym łącznikiem Luer z zatyczką?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 143

Pakiet nr 4, pozycje 3, 4, 11, 12, 13, 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Pakiet 4 jest podzielony na pozycje od wszczęcia posterowania.

Pytanie nr 144

Pakiet nr 5, pozycje 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Pakiet 5 jest na pozycje od wszczęcia postępowania.

Pytanie nr 145

Pakiet nr 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z balonem 3ml dla rozmiaru CH 6, balonem 3-5 ml dla rozmiarów CH 8 – 10 oraz balonem 5-10ml dla rozmiarów CH 12 – 24?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów.

Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczalne zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 146

Pakiet nr 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a 100% silikon z balonem 3ml dla rozmiaru CH 6, balonem 3-5 ml dla rozmiarów CH 8 – 10 oraz balonem 5-10ml dla rozmiarów CH 12 – 24?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów.

Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczalne zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 147

Pakiet nr 5, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a 100% silikon bez żelu?

W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ (Pakiet 5 jest podzielony na pozycje i możliwe jest składanie ofert w zakresie poszczególnych pozycji od wszczęcia postępowania.)

Pytanie nr 148

Pakiet nr 5, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemann w rozmiarach CH 8 – 24?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 149

Pakiet nr 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sondy do karmienia CH6-CH8 o długości 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 150

Pakiet nr 18, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z drzewa oskrzelowego bez filtra? W przypadku negatywnej odpowiedzi, czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ (Pakiet 18 jest podzielny na pozycje od wszczęcia postępowania i możliwe jest składanie ofert w zakresie poszczególnych pozycji.)

Pytanie nr 151

Pakiet nr 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiar rękawic od 6,5 do 9,0?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 152

Pakiet nr 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice obustronnie polimerowane, długość rękawicy min. 280mm, grubość palca 0,33mm ($\pm 0,01$), na dłoni 0,27mm ($\pm 0,02$), na mankiecie 0,22mm ($\pm 0,01$)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 153

Pakiet nr 22, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie mieszczące 2 szt. rękawic chirurgicznych z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawca, natomiast w celu ułatwienia wyceny jednej sztuki wyrobu, dopuszcza przedstawienia ceny jednostkowej z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Jednocześnie przypominamy, że w Rozdziale XIII SIWZ w części: „UWAGA” Zamawiający określił w jaki sposób Wykonawcy powinni wyliczyć oferowane ilości wyrobu, tak aby oferta była zgodna z wymaganiami.

Pytanie nr 154

Pakiet nr 22, pozycja 2

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Pakiet 22 jest na pozycje od wszczęcia postępowania

PYTANIA WYKONAWCY NR 21

Pytanie nr 155

Pakiet 20

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści: kaniule przeznaczone dla małych i delikatnych żył u wcześniaków i noworodków, bez portu i zdejmowalnego uchwytu, ze skrzydełkami ułatwiającymi wprowadzenie kaniuli, wykonana z FEP, bez lateksu, bez PVC, opakowanie folia, papier klasy medycznej, rozmiary: 0,6 x 19mm przepływ 19ml/min; 0,7 x 19mm przepływ 29ml/min?Pytanie nr 155

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 156

Pakiet 20

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści: kaniule do żył obwodowych, ze skrzydełkami i portem iniekcyjnym, wykonane z biokompatybilnego poliuretanu, bez lateksu i PVC, z filtrem hydrofobowym, opakowanie folia, papier klasy medycznej, rozmiary: 09 x25mm przepływ 42ml/min; 1,0 x 32mm przepływ 59ml/min; 1,3 x 32mm przepływ 103 ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 157

Pakiet 20

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści: kaniule ze skrzydełkami i portem iniekcyjnym działającym w bezpiecznym systemie zatraskowym typu "klik", domykany standardowo, wykonane z biokompatybilnego poliuretanu, bez lateksu i PVC, z filtrem hydrofobowym, z 3 grubymi wtopionymi paskami kontrastującymi w RTG, z filtrem hydrofobowym, opakowanie folia, papier klasy medycznej, sterylizacja EO, rozmiary:

- 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min
- 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min
- 18G (1,30) - dł. 32mm; przepły 103 ml/min
- 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ 96 ml/min
- 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ 155 ml/min
- 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ 225 ml/min
- 14G (2,00)- dł. 45mm; przepły 290 ml/min?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 158

Pakiet 20

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 3 do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź: Pakiet 20 jest podzielony na pozycje od wszczęcia postępowania i możliwe jest składanie ofert w zakresie poszczególnych pozycji.

Pytanie nr 159

Pakiet nr 4 przedłużacze, przyrządy do infuzji, dreny do pomp Poz. 9

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przyrządy do przetoczeń z precyzyjnym regulatorem przepływu (przeplęwomierzem), powinny posiadać regulację prędkości w zakresie min. 0-250ml/h oraz dwuczęściową komorę kropłową, gdzie dolna część komory powinna być elastyczna o porównywalnej wielkości do sztywnej górnej części komory, oddzielona specjalnym pierścieniem stabilizującym, ułatwiającym wygodny uchwyt i wkłucie w każdego rodzaju pojemniki z płynami infuzyjnymi.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 160

Pakiet nr 4 przedłużacze, przyrządy do infuzji, dreny do pomp Poz. 9

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przyrządy z precyzyjnym regulatorem przepływu, użytkowane w warunkach klinicznych powinny posiadać możliwość identyfikacji wyrobu medycznego, określającym jego pochodzenie i rodzaj (także po wyjęciu z opakowania jednostkowego i użyciu), poprzez oznaczenie na samym wyrobie np. logo lub nazwy producenta, nazwy własnej lub numeru serii lub innych danych identyfikacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 161

Pakiet nr 6 Igły do znieczuleń, zestawy do znieczuleń, igły do splotów, akcesoria Poz. 5, 13

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły, analogicznie do igieł z poz. 15-17, powinny posiadać wbudowany, widoczny z każdej strony uchwytu pryzmat, zmieniający barwę po wypełnieniu PMR.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że pryzmat zmieniający barwę po wypełnieniu PMR, w Pakiecie 6, powinny posiadać igły z pozycji 1 i 5 (analogicznie do igieł z poz. 12, 15-17).

Pytanie nr 162

Pakiet nr 20 kaniule do długotrwałych wlewów dożylnych Poz. 3

Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania w tej pozycji opisanych poniżej kaniul dożylnych Vasofix Certo firmy B/Braun, z powodzeniem używane w wielu szpitalach RP, a także od wielu lat użytkowane w Państwa Placówce.

Kaniule ze skrzydełkami, z samodomykalnym portem bocznym oraz koreczkiem zamykanym w znacznie bezpieczniejszym systemie, niż wskazany w siwz, zapobiegającym niezamierzonemu otwarciu dostępu do portu bocznego, wykonane z biokompatybilnego PU, bez lateksu, bez PCV, kontrastujące w RTG (4 wtopione w ścianki kaniuli, symetrycznie rozłożone paski kontrastujące), o wysokim współczynniku penetracji /ostrości/, z zastawką antyzwrotną w postaci filtra hydrofobowego, skutecznie zapobiegającą wypływowi krwi podczas wkłucia, a jednocześnie wyrównującym ciśnienia osmotyczne, widoczna data ważności na opakowaniu jednostkowym - sterylne, sterylizowane EO, opakowanie typu blister z papierem klasy medycznej, w poniższych rozmiarach:

0,9 mm x 25mm; przepływ: 36 ml/min - G22 (niebieski),

1,1 mm x 33 mm ; przepływ: 61 ml /min - G20 (różowy),

1,3 mm x 45 mm; przepływ: 96 ml /min - G18 (zielony),

1,5 mm x 45 mm; przepływ: 128 ml /min - G17 (biały),

1,7 mm x 50 mm; przepływ: 196 ml /min - G16 (szary),

2,2 mm x 50 mm ; przepływ: 343 ml /min - G14 (pomarańczowy)

Wnioskowane dopuszczenie, poszerzy grono potencjalnych Wykonawców i zapewni Zamawiającemu korzystny wybór jakościowy i cenowy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 163

Pakiet nr 20 kaniule do długotrwałych wlewów dożylnych Poz. 3

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylne, użytkowane w warunkach klinicznych powinny posiadać możliwość identyfikacji wyrobu medycznego, określającym jego pochodzenie i rodzaj (także po wyjęciu z opakowania jednostkowego i użyciu), poprzez oznaczenie na samym wyrobie np. logo lub nazwy producenta, nazwy własnej lub numeru serii lub innych danych identyfikacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 164

Pakiet nr 20 kaniule do długotrwałych wlewów dożylnych Poz. 3

Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisem rozdz. III pkt. 2 SIWZ, istnieje możliwość składania oferty na każdą pozycję w pakiecie osobno.

Odpowiedź: Pakiet 20 jest podzielony na pozycje od wszczęcia postępowania i możliwe jest składanie ofert w zakresie poszczególnych pozycji.

PYTANIA WYKONAWCY NR 23**Pytanie nr 165**

Dotyczy Pakietu 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści łyżki w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 166

Dotyczy Pakietu 9 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga łyżek z metalową podstawą łyżki (co zapewnia lepsze mocowanie z rękojeścią niż łyżki z podstawą plastikową), przy zachowaniu pozostałych wymagań SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 167

Dotyczy Pakietu 19 poz. 2, 4, 7

Czy Zamawiający dopuści wyroby wykonane z medycznego PCV, ze śladową ilością ftalanów, przy zachowaniu pozostałych wymagań SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 168

Dotyczy Pakietu 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wyroby wykonane z medycznego PCV, przy zachowaniu pozostałych wymagań SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

PYTANIA WYKONAWCY NR 24**Pytanie nr 169**

Dotyczy zapisów siwz:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości Wykonawców do przedłożenia dokumentów dopuszczających, katalogów oraz próbek zaoferowanego sprzętu, celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ? Wprowadzenie powyższego jest uzasadnione tym, aby Zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji ofert złożonych przez Wykonawców, mógł dokonać oceny czy dany Wykonawca nie podlega odrzuceniu a oferowany sprzęt medyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp).

Odpowiedź: Zamawiający na podstawie art. 26 ust 1 wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia m.in. Dokumentów dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia, tj. wydane/opublikowane przez wytwórcę ulotki informacyjne, foldery (lub części folderów), katalogi (lub części katalogów), karty techniczne etc., w których opisano/wskazano kluczowe cechy, parametry, właściwości itp. oferowanego przedmiotu zamówienia, w szczególności w kontekście opisu przedmiotu zamówienia sporządzonego przez Zamawiającego oraz Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania umieszczone przez Zamawiającego w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” w Załączniku 2A (formularzu asortymentowo-cenowym) zakresie części, na którą Wykonawca składa ofertę. Zamawiający opisał ten wymóg w Rozdziale VII pkt 4 SIWZ.

Pytanie nr 170

Pakiet 2: Poz.1-4:

Prosimy o dopuszczenie podania ceny za opakowanie zbiorcze strzykawek z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o dopuszczenie podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet czterech m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby ceny jednostkowe netto były określone do 4 miejsc po przecinku.

Pytanie nr 171

Pakiet 2: Poz.1-4:

Czy tłok strzykawki w celu zapewnienia jego stabilności i pewnego chwytu ma posiadać zwężenia jego obwodu mierzone od części chwytnej tłoka (pierścienia zewnętrznego) nie większe niż 25%-30% całej długości tłoka?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 172

Pakiet 2: Poz.1-4:

Prosimy o sprecyzowanie czy strzykawki mają posiadać oryginalnie nadrukowaną na cylindrze skalę odpowiadającą dokładnie pojemności nominalnej strzykawki (bez rozszerzenia) tj, dla poj. 2ml – skala do 2ml, dla poj. 5ml- skala do 5ml, dla poj.10ml – skala do 10ml i dla poj.20ml- skala do 20ml, tak jak obecnie stosowane produkty?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 173

Pakiet 2: Poz.7 i 8:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowani strzykawek o poj. 50/60ml ze skalą co 1ml do 60ml, spełniających pozostałe wymagania siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 174

Pakiet 2: Poz.7 i 8:

Prosimy o sprecyzowanie czy poza cylindrem, także tłok strzykawki ma być wykonany z polipropylenu- materiału gwarantującego szczelność strzykawki i płynność przesuwu tłoka?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 175

Pakiet 2: Poz.7 i 8:

Prosimy o sprecyzowanie czy na cylindrze ma się znajdować oryginalnie nadrukowane logo i nawa własna typu strzykawki w celu łatwej identyfikacji strzykawek bez opakowania jednostkowego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 176

Pakiet 2: Poz.7 i 8:

Prosimy o sprecyzowanie czy w związku z wymogiem „do pomp Abott, Ascor, Braun” Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek wymienionych w instrukcji użycia posiadanych pomp strzykawkowych oraz w ich menu, co gwarantuje bezawaryjną infuzję?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby zaoferowane strzykawki były wymienione w instrukcji użycia posiadanych pomp.

Pytanie nr 177

Pakiet 2: Poz.7 i 8:

W związku z wymogiem „do pomp Abbott, Ascor, Braun” prosimy Zamawiającego o podanie typów posiadanych pomp strzykawkowych w celu zaoferowania strzykawek wymienionych w instrukcji ich użycia, co gwarantuje bezawaryjną infuzję.

Odpowiedź: Zamawiający posiada pompy: ASCOR typ AP22, ASCOR typ SEP 21s, BRAUN typ 8713030

Pytanie nr 178

Pakiet 2: Poz.7 i 8:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby strzykawki były kompatybilne z lekami cytostaticznymi, przeznaczonymi do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków, co będzie potwierdzone oświadczeniem producenta dołączonymi do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 179

Pakiet 2: Poz.7 i 8:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby strzykawki 50 ml były skalowane co 1 ml do 60 ml, co zapewnia bardziej precyzyjną podaż leku?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga skalowania co 1 ml.

Pytanie nr 180

Pakiet 2: Poz.6, 10, 11,12:

Prosimy o sprecyzowanie czy poza cylindrem, także tłok strzykawki ma być wykonany z polipropylenu- materiału gwarantującego szczelność strzykawki i płynność przesuwu tłoka?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 181

Pakiet 2: Poz.6, 10, 11,12:

Prosimy o sprecyzowanie czy na cylindrze ma się znajdować oryginalnie nadrukowane logo i nawa własna typu strzykawki w celu łatwej identyfikacji strzykawek bez opakowania jednostkowego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 182

Pakiet 2: Poz.6, 10, 11,12:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby strzykawki były kompatybilne z lekami cytostaticznymi, przeznaczonymi do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków, co będzie potwierdzone oświadczeniem producenta dołączonymi do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 183

Pakiet 2: Poz. 10:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylnych strzykawek pakowanych w opakowanie (worek foliowy) po 10szt, bez opakowania jednostkowego, zabezpieczonych specjalnym kapturkiem gwarantujących sterylność produktu do momentu jego zdjęcia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawca pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 184

Pakiet 3: Poz. 9:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowani igły tępej specjalnie dedykowanej do pobierania leków, bez otworu bocznego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 185

Pakiet 3: Poz. 10:

Prosimy o sprecyzowanie czy wymagany filtr ma być wielkości 5 mikronów, co gwarantuje efektywną filtrację drobin szkła, metalu, gumy i innych zanieczyszczeń?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 186

Pakiet 3: Poz. 10:

Prosimy o sprecyzowanie czy igły mają cechować się długością nasadki igły min. 23mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 187

Pakiet 3: Poz. 10:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy igły tępej z filtrem z ostrzem ściętym pod kątem 45 stopni co zapewnia pełne bezpieczeństwo personelu medycznego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 188

Pakiet 3: Poz. 11:

Prosimy o sprecyzowanie czy igły mają być sterylizowane radiacyjnie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 189

Pakiet 3: Poz. 11:

Prosimy o doprecyzowanie czy zaofertowane igły mają być kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi na rynku penami insulinowymi z dołączonym do oferty certyfikatem kompatybilności technicznej potwierdzającym w.w fakt?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wymagalność kompatybilności igieł z penami insulinowymi. Cecha ta powinna być potwierdzona dokumentami dostarczonymi przez Wykonawcę na wezwanie na podstawie art. 26 ust. 1 uPzp.

Pytanie nr 190

Pakiet 5: Poz.1-4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Dufour trójdrożnych w rozmiarach 18-24, tak jak obecnie stosowane.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy w zakresie cewników Dufour (poz. 3 została zmodyfikowana na cewnik Foleya) pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 191

Pakiet 5: Poz.1-4:

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być pakowane w opakowanie podwójne- wew. worek foliowy i zew. opakowanie folia/papier, co pozwala na ich aseptyczne użycie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga ww. sposobu pakowania.

Pytanie nr 192

Pakiet 5: Poz.1 i 2:

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki trójdrożne Dufour, jak obecnie stosowane, mają być wykonane z półtwardego silikonowego lateksu, co ułatwia ich aplikację?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga cewnika wykonanego z materiału opisanego w zapytaniu.

Pytanie nr 193

Pakiet 5: Poz. 2:

Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka i Zamawiający oczekuje zaoferowania cewników trójdrożnych z prostą końcówką z końcówką nelaton wykonanych z przezroczystego silikonu z min.5 otworami drenującymi poniżej balonu, co umożliwi prawidłowy drenaż?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 194

Pakiet 5: Poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników Dufour trójdrożnych z zagiętą końcówką w rozm.18-24ch.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 195

Pakiet 5:Poz. 3 i 4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w celu zmniejszenia traumatyzacji cewki moczowej cewniki wykonane z silikonu mają być pokryte hydrożelem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 196

Pakiet 5:Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie cewników dufour z zagiętą końcówką w rozm.18ch -24ch.

Odpowiedź:Zamawiający zmodyfikował SIWZ w zakresie Pakietu nr 5, poz. 3 i wymaga zgodnie z dokonanymi zmianami.

Pytanie nr 197

Pakiet 5: Poz.1-4:

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają posiadać balon 50 ml oraz 80 ml do wyboru przez Zamawiającego przy każdorazowym zamówieniu?

Odpowiedź:Zamawiający wymaga jak. W treści zapytania dla pozycji 1, 2 oraz 4 Pakietu 5.

Pytanie nr 198

Pakiet 5: Poz.5:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników foley z lateksu silikonowanego z balonem 3-10ml w rozm 6-24ch (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 199

Pakiet 5:Poz.6:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników foley 100% silikon z balonem w zakresie od 1,5ml do 10ml (w zależności od rozmiaru cewnika) w rozm. Od 6-24ch.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 200

Pakiet 5:Poz.7:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników foley 100% silikon z dołączoną strzykawką z 10% roztworem gliceryny służącą do wypełniania balonu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 201

Pakiet 5: Poz.7:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników foley 100% silikon z balonem w zakresie od 1,5ml do 10ml (w zależności od rozmiaru cewnika) w rozm. Od 6-12ch.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 202

Pakiet 5: Poz.6 i 7:

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być w pełni przezroczyste, co pozwala na kontrolę barwy gromadzonej wydzieliny?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga cewników w pełni przezroczystych w poz. 6 i 7 Pakietu 5.

Pytanie nr 203

Pakiet 5: Poz.10:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawów do szynowania w rozm. 4,8ch(zamiast 4,7ch)-7ch, spełniających pozostałe wymogi siwz. Nadmieniamy, iż różnica pomiędzy rozmiarami 4,8ch a 4,7ch jest niezauważalna dla operatora.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 204

Pakiet 5: Poz.10:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy zestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów wykonanych z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan?

Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie 5 w pozycji 10 wymaga materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan.

Pytanie nr 205

Pakiet 9: Poz.1:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje dostawy łyżek światłowodowych jednorazowego użytku typu Miller w rozmiarach: 00, 0, 1? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował SIWZ w zakresie Pakietu nr 9, poz. 1 i wymaga zgodnie z dokonanymi zmianami.

Pytanie nr 206

Pakiet 9: Poz.2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje dostawy łyżek światłowodowych jednorazowego użytku typu MacIntosh w rozmiarach: 2,3,4,5? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował SIWZ w zakresie Pakietu nr 9, poz. 2 i wymaga zgodnie z dokonanymi zmianami.

Pytanie nr 207

Pakiet 9: Poz. 1i 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek metalowych w opakowaniu typu folia-folia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 208

Pakiet 9: Poz. 1i 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy łyżek metalowych które, posiadają światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego (akryl), dający mocne, światło, nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło, z wyraźnym oznakowaniem typu i rozmiaru łyżki na części metalowej i symbolu „jednorazowego użytku” w formie przekreślona cyfra 2?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 209

Pakiet 9: Poz. 3 i 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek gdzie oznaczenie CE, symbol „jednorazowego użycia” oznaczenie typu łyżki i rozmiaru – są umieszczone po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy w oferowanym Pakiecie wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 210

Pakiet nr 10 Poz.1:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego w składzie: kaniula rozdzielalna, cewnik 8ch dł.40cmz poliuretanu, z zamkniętym końcem, z otworami bocznymi, znakowany, klamra, szpulka mocująca, worek na mocz 2l, sterylny, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia papier, oznaczenie rozmiaru i data ważności an opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 211

Pakiet nr 10 Poz.2:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego w składzie: kaniula rozdzielalna, cewnik 8ch dł.40cmz poliuretanu, z zamkniętym końcem, z otworami bocznymi, znakowany, klamra, szpulka mocująca, worek na mocz 2l, sterylny, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia papier, oznaczenie rozmiaru i data ważności an opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 212

Pakiet nr 10 Poz.2:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego w składzie: kaniula rozdzielalna, cewnik 11ch dł.45cmz poliuretanu, z zamkniętym końcem, z otworami bocznymi, znakowany, klamra, szpulka mocująca, worek na mocz 2l, sterylny, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia papier, oznaczenie rozmiaru i data ważności na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 213

Pakiet nr 10 Poz.3:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego w składzie: kaniula rozdzielalna, cewnik 11ch lub 14ch dł.45cmz poliuretanu, z zamkniętym końcem, z otworami bocznymi, znakowany, klamra, szpulka mocująca, worek na mocz 2l, sterylny, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia papier, oznaczenie rozmiaru i data ważności na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 214

Pakiet nr 10 Poz.4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu przezskórnego w rozmiarach: 8-10 F, sterylny, igła dwuczęściowa typu Chiba 18G, dł. 20cm, widoczna w USG i skalowana co 1 cm. Cewnik poliuretanowy o długości całkowitej 300mm, pokryty na odcinku dystalnym (ok. 90mm) do-nerkowym powłoką hydrofilną z balonem 2-2,5ml. Prowadnica typu Lunderquist dł. 80cm z miękkim i bezpiecznym końcem typu J, kranik trójdrożny, łącznik do worka na mocz. Pakowane pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 215

Pakiet nr 10 Poz.5:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania prowadnicy Lunderquista, miękkiej na długości 4,5 cm, półsztywnej na długości 5,5cm, sztywnej na dalszej długości, prostej lub z zagięciem typu J, wykonanej ze stali nierdzewnej lub pokrytej PTFE, średnicy 0,035" długości 85cm, sterylnej, opakowanie jednostkowe typu blister folia/folia-papier z oznaczeniem rozmiaru i daty ważności na opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 216

Pakiet nr 12 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy zamkniętego systemu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną (fabrycznie połączonego z zestawem do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylnego i w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), z 20 ml drenem manometrycznym wyposażonym w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, z zastawką antyzwrotną wbudowaną w łącznik do cewnika foley, ze zintegrowanym zaciskiem drenu i bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zamkniętego systemu do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną (fabrycznie połączonego z zestawem do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylnego i w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), z 20 ml drenem manometrycznym wyposażonym w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, z zastawką antyzwrotną wbudowaną w łącznik do cewnika foley, ze zintegrowanym zaciskiem drenu i bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni.

Pytanie nr 217

Pakiet nr 12 Poz. 2:

Prosimy Zamawiającego czy wymaga przedłożenia do oferty badań klinicznych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania systemu przez 29 dni?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 218

Pakiet nr 12: Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy worka z miękkim drenem antyzłamaniowym o długości 120cm, z zastawką antyzwrotną, w opcji ze zintegrowanym wieszakiem, ze szczegółową skalą co 25ml do 100ml, z białą tylną ścianą worka, z nadrukowaną instrukcją opróżniania worka, z wentylowaną zakładką na kranik spustowy, zaopatrzony w podwójne, wzmocnione zgrzewy oraz port bezigłowy do pobierania próbek z okienkiem do kontroli procesu, z potwierdzonym użycie do 7 dni? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 219

Pakiet nr 12: Poz. 5

Prosimy o doprecyzowanie czy port bezigłowy ma być wyposażony w przezroczyste okienko do kontroli procesu pobierania próbek moczu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 220

Pakiet nr 12: Poz. 5

Prosimy Zamawiającego podanie minimalnej powierzchni silikonowej membrany podlegającej dezynfekcji w porcie do pobierania próbek moczu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 221

Pakiet nr 12: Poz. 6

Prosimy o doprecyzowanie czy zestaw do godzinowej zbiórki moczu ma być wyposażony w dren dwuświatłowy, co umożliwia swobodne spływanie moczu pomimo zamkniętej zastawki w łączniku, a co za tym idzie eliminować konieczność rozłączania systemu celem uzyskania precyzyjnego pomiaru godzinowej zbiórki moczu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby zestaw do godzinowej zbiórki moczu ma być wyposażony w dren dwuświatłowy, co umożliwia swobodne spływanie moczu pomimo zamkniętej zastawki w łączniku, a co za tym idzie eliminować konieczność rozłączania systemu celem uzyskania precyzyjnego pomiaru godzinowej zbiórki moczu.

Pytanie nr 222

Pakiet nr 12: Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby zestaw do godzinowej zbiórki moczu posiadał bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby zestaw do godzinowej zbiórki moczu posiadał bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek.

Pytanie nr 223

Pakiet nr 12: Poz. 6

Prosimy o wyjaśnienie czy sterylny, zamknięty system do godzinowej zbiórki moczu ma posiadać kranik spustowy mocowany w otwartej zakładce ku górze, co zapobiega przed ewentualną kontaminacją podłoża moczem?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby sterylny, zamknięty system do godzinowej zbiórki moczu posiadał kranik spustowy mocowany w otwartej zakładce ku górze, co zapobiega przed ewentualną kontaminacją podłoża moczem.

Pytanie nr 224

Pakiet nr 12: Poz. 6

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby worki do godzinowej zbiórki moczu w celu łatwości mocowania posiadały minimum 3 niezależne sposoby podwieszania?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 225

Pakiet nr 12: Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dren do komory pomiarowej ma posiadać spiralę antyzałamaniową co zabezpiecza przed załamaniem drenu i ryzykiem zalegania moczu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby dren do komory pomiarowej posiadał spiralę antyzałamaniową co zabezpiecza przed załamaniem drenu i ryzykiem zalegania moczu

Pytanie nr 226

Pakiet nr 12: Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy worek do godzinowej zbiórki moczu ma zabezpieczać przed cofaniem się moczu z drenu do cewnika foley?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby worek do godzinowej zbiórki moczu zabezpieczał przed cofaniem się moczu z drenu do cewnika foley.

Pytanie nr 227

Pakiet nr 12: Poz. 6